



- NOTAS:
- EL SILENCIADOR DE DESCARGA SE ENVIARÁ SUELTO.
 - PESO DEL EQUIPO FUENTE DE VACÍO MÉDICO QUIRÚRGICO Y WAGD : 2820.5 LBS
 - ☒ INDICA PUNTOS DE ELEVACIÓN
 - INDICA CENTRO DE GRAVEDAD
 - TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN EN PULGADAS







DETALLE DE EQUIPO FUENTE DE VACÍO MÉDICO QUIRÚRGICO Y WAGD

S/E

ESPACIO MÍNIMO PARA MANTENIMIENTO Y VENTILACIÓN

Ø 0.75 PERFORACION PARA BARRENO (8 PUNTOS)

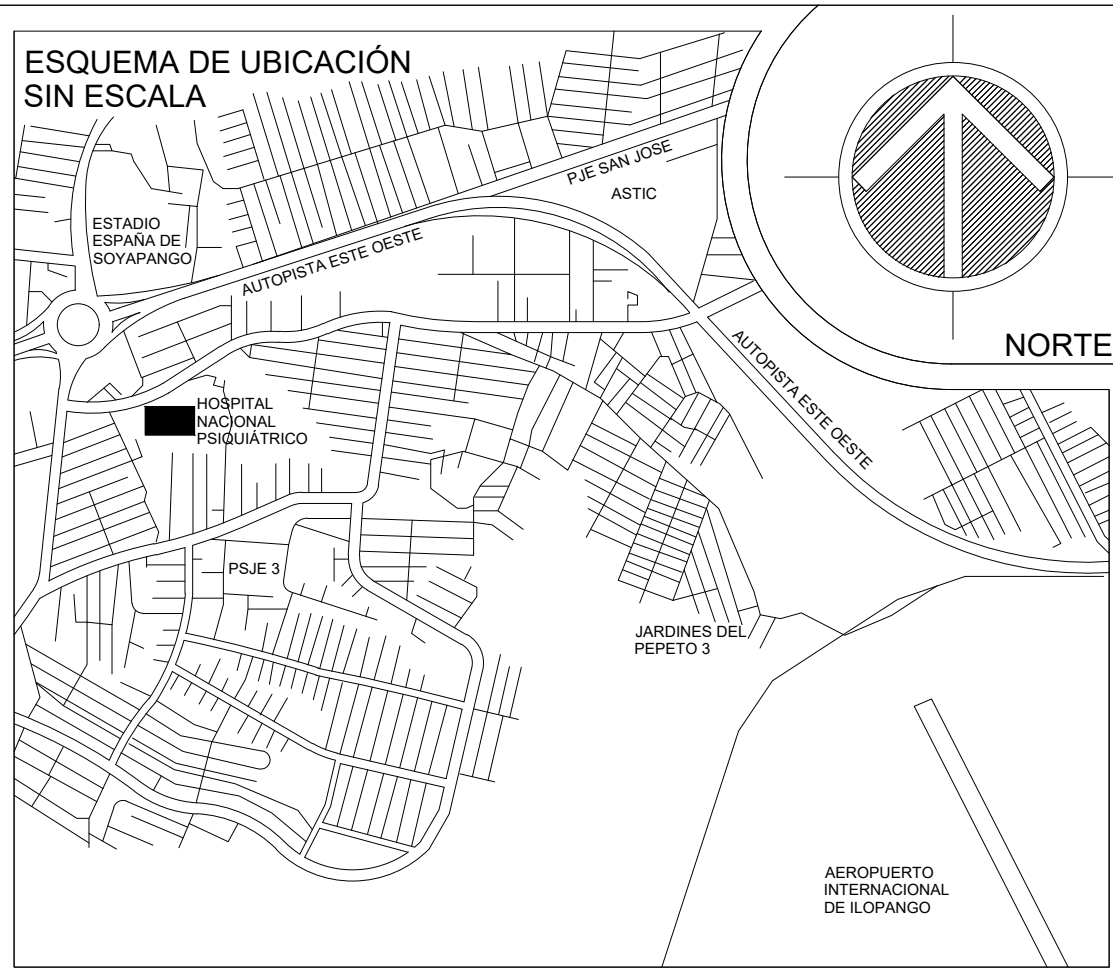

 GOBIERNO DE EL SALVADOR		REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE SALUD UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA PRIDES II	
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE SOYAPANGO			
CONCURSO No:			
DIRECCIÓN: CALLE LA FUENTE, CANTON VENECIA, SOYAPANGO SAN SALVADOR			
CONTENIDO: DETALLES DE INSTALACIÓN DE GASES MÉDICOS 04 - DETALLE DE EQUIPO FUENTE DE VACIO MEDICO QUIRURGICO Y WAGD			
DISEÑO ARQUITECTONICO: UGPPI/MINSAL		DISEÑO ESTRUCTURAL: UGPPI/MINSAL	
DISEÑO ELECTRICO: UGPPI/MINSAL		DISEÑO HIDRAULICO: UGPPI/MINSAL	
REVISO Y APROBO:		ESCALA: INDICADAS	FECHA: SEPTIEMBRE 2024
AREA TOTAL:	AREA CONSTRUIDA: 2143.55 m2	HOJA No.: GM-09	CORRELATIVO: 09/10